

C I R C U L A R N ° 1

5000003096

“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AMETEK”

A todas las Empresas interesadas, hacemos llegar la siguiente información para la solicitud de cotización de referencia:

- 1. PREGUNTA.** – ¿Favor brindarnos información del número de serie del analizador, no del modelo?


RESPUESTA. - Adjunto los datos solicitado

ANALIZADORES DE CONTAMINANTES GAS NATURAL		
MARCA	MODELO	N/SERIAL
AMETEK	933	ZZ-933-S570
AMETEK	241	ZZ-241-S750
AMETEK	3050	305C693


- 2. PREGUNTA.** – ¿Cuál es la unidad principal con la que se utilizan estas piezas? ¿Alguna información de la placa de identificación o etiqueta de marca del OEM??

RESPUESTA. - Adjunto los datos solicitado


Analizador de Azfrado Ametek 933

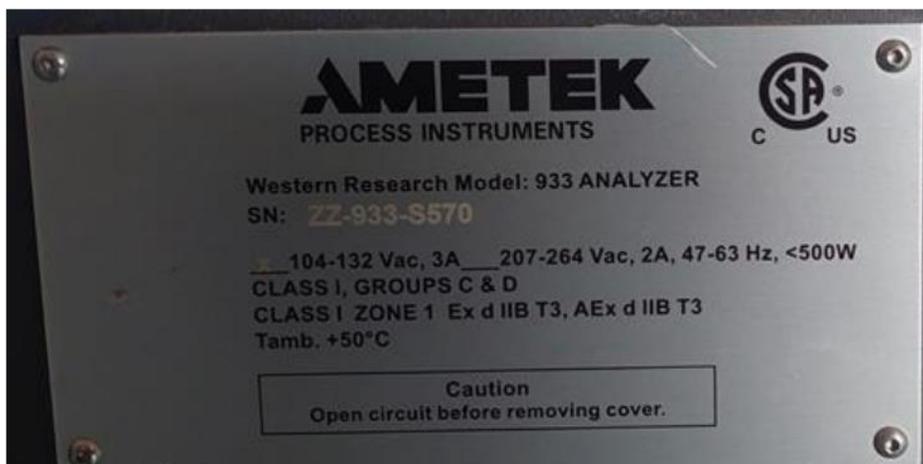

Analizador de Humedad Ametek 3050 OLV

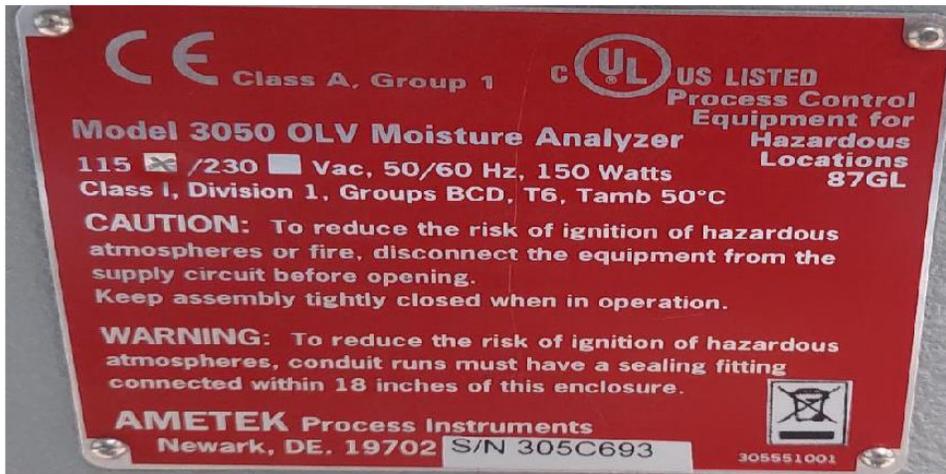

Analizadores Punto de Rocio Ametek 241 CE

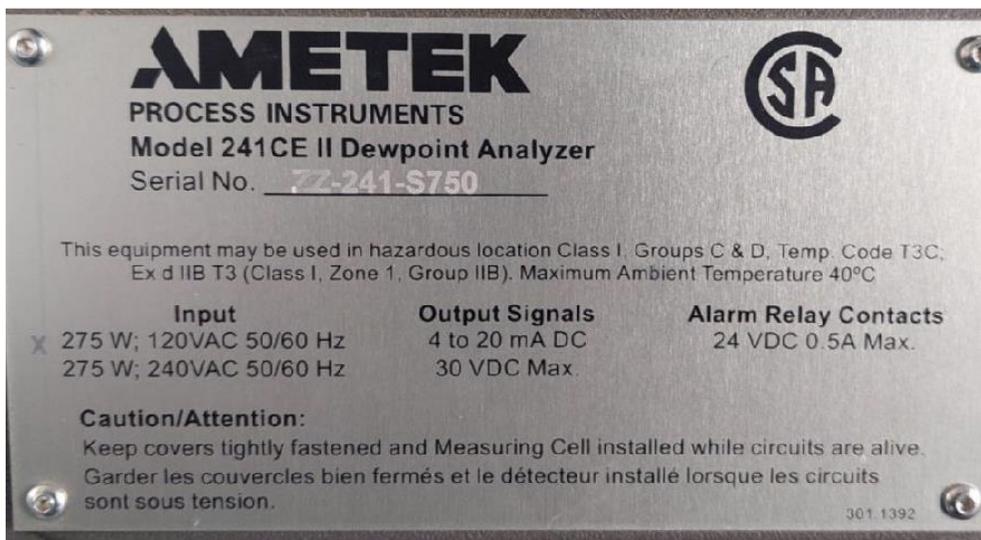

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente **Circular1**, con el fin de que no tengan inconvenientes en subir su oferta al SRM.

Santa Cruz, 06 de junio de 2022